

健診検査センターニュース

No.532 号

検査内容変更のお知らせ


平素より当センターをご利用頂きまして、誠にありがとうございます。
この度、下記の検査項目内容を変更させて頂くことになりましたので、お知らせ致します。
何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

変更日：平成 27 年 7 月 6 日（月）より変更

変更項目：1223 N-アセチルグルコサミニダーゼ（NAG）

	（新）	（旧）
検体量	部分尿 0.5mL	部分尿 0.5mL 蓄尿 0.5mL（削除）
基準値	部分尿 0.7~11.2 (IU/L)	部分尿、蓄尿ともに 7.0 以下 (U/L)
報告範囲	0.4 未満、0.4~999999.9	0.1 未満、0.1~999999.9
備考	現測定試薬販売中止に伴い、測定試薬を変更させていただきます。検査方法は変更ありませんが、基準値（単位）および報告範囲が変更となります。 また、本変更に伴い、蓄尿材料での受託は中止とさせていただきます。	

▼現法と新法の比較

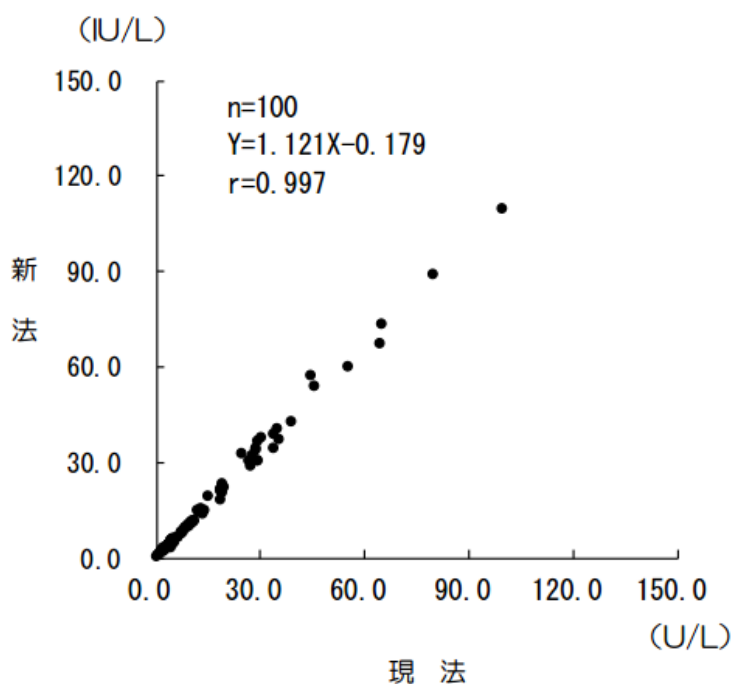

公益社団法人函館市医師会 函館市医師会健診検査センター
TEL 0138-57-6571・FAX 0138-57-6580
E-mail: info@hma-labo.jp